

L'application, l'activation, la désactivation, la réparation et l'entretien périodique d'attachements doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié. D'autre part, seuls les instruments appropriés et les pièces d'origine doivent être employés pour ces opérations.

Le nettoyage manuel des attachements à l'aide de brosses à dents et de dentifrice abrasif peut être à l'origine d'une usure prématurée des pièces fonctionnelles.

La parution de ce mode d'emploi rend caduques toutes les Versions antérieures.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent de la non-observation du mode d'emploi suivant.

Directives générales pour charnières

Traçabilité des numéros de lots

Si des attachements sont composés à l'aide de pièces ayant des numéros de lots différents, il faut noter tous les numéros de lots concernés, afin de pouvoir assurer la traçabilité.

Couronnes jumelées

La solidarisation de deux piliers contigus par des couronnes au niveau de chaque quadrant latéral est la condition idéale requise pour la fixation et l'assise de prothèses articulées à extension uni- et bilatérales.

Surfaces occlusales métalliques

Elles se situent au-dessus des parties femelles et protègent le maintien de ces dernières dans la résine. Il est formellement déconseillé de braser des parties femelles de charnières à une armature quelconque.

Démontage de l'attachement

Avant tout traitement thermique (mise en revêtement pour coulée de raccord, brasage, durcissement, cuissons de céramique), il est impératif de démonter toutes les pièces composant les parties mâles et femelles des charnières.

Précautions brasage OSV

IMPORTANT!

L'alliage OSV ne doit, en aucun cas, être recuit ou durci après le brasage. (Risque de fragilisation de l'alliage). Les attachements en OSV s'oxydent très fortement pendant le brasage et, de ce fait, nécessitent, après décapage un traitement de surface qui consiste à frotter les pièces oxydées à l'aide d'un pinceau en fibre de verre: l'alliage retrouvera ainsi son aspect d'origine. En aucun cas, les pièces ne seront traitées par des moyens abrasifs tels que sablage ou pâte à pré-polir.

Décapage

L'oxydation qui survient lors du brasage d'une partie femelle en Doral peut être éliminée dans une solution chaude d'acide sulfurique à 10 % vol. (H₂SO₄).

Remarque: Les acides chlorhydrique (HCl), nitrique (HNO₃) ou le Neacid ne conviennent pas au décapage de l'alliage Doral car ces acides peuvent dissoudre l'alliage. Une alternative existe pour éliminer l'oxyde, par la technique de projection de perles de verre avec une pression de 1.5 bar.

Les parties traitées à l'acide coulisent mieux entre elles après décapage, lorsqu'elles sont déposées quelques instants dans l'eau savonneuse (à l'ultrason).

Désinfection

Après chaque finition ou modification, les travaux prothétiques, y compris les composants de la partie femelle, doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux directives nationales. Lors du choix du désinfectant, il faut veiller à ce que:

- il soit adapté au nettoyage et à la désinfection des composants dentaires prothétiques;
- il soit compatible avec les matériaux des produits à nettoyer et à désinfecter;
- son efficacité lors de la désinfection soit avérée.

Toutes les pièces en plastique doivent être désinfectées avant utilisation à l'aide d'un désinfectant homologué par l'EPA de niveau haut.

Recommandation: solution Cidex® OPA. Respecter impérativement les données du fabricant.

Directives complémentaires

Pour l'utilisation des alliages de métaux précieux, les informations concernant la coulée de raccord ou le brasage se trouvent dans la documentation Dental de Cendres+ Métaux et sur le site Internet www.cmsa.ch/dental.

Avertissements

Allergies

Pour un patient allergique à un ou plusieurs éléments d'un matériau d'attachement, ce produit ne doit pas être utilisé. Pour un patient qui a le soupçon d'être allergique à un ou plusieurs éléments de ces matériaux, on lui fera subir préalablement un test allergologique pour clarifier son incertitude et démontrer que l'on peut utiliser ce produit s'il ne présente pas de réaction allergique. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à votre représentant Cendres+ Métaux.

Les instruments auxiliaires peuvent contenir du nickel.

Le risque de surchauffe et de déplacement du produit n'a pas été testé en environnement IRM.

Mesures de précaution

- Les pièces sont livrées non stériles La préparation conforme des pièces, avant leur montage sur le patient, est expliquée au chapitre « Désinfection ».
- Veiller au nettoyage régulier de la glissière afin d'éviter toute inflammation des tissus mous.
- En cas d'utilisation intra-orale, tous les produits doivent de manière générale être fixés, pour éviter tout risque d'aspiration.
- Aucun travail de coupe ne doit avoir lieu dans la bouche du patient.

EO

Partie femelle

Intégration par: Polymerisation

Partie mâle

Intégration par: Brasage

E = Elitor®

O = OSV

EC

Partie femelle

Intégration par: Polymerisation

Partie mâle

Coulée de raccord ou brasage

E = Elitor®

C = Ceramicor®

DK

Partie femelle

Intégration par: Polymerisation

Partie mâle

Plastique intégralement calcinable pour technique de coulée

D = Doral

K = Korak

Indications

- Prothèses articulées à extension uni et bilatérales.
- Selles prothétiques courtes ou étendues avec armature transversale.

Contre-indications

- Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du matériau de fixation.
- Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes de suivi et de rappel.
- Patients atteints de bruxisme ou d'une autre habitude para-fonctionnelle non contrôlée.
- Prothèses unilatérales sans équilibrage transversal
- Prothèses intercalées

Particularités

La charnière Mini-Dalbo® se distingue par sa construction simple qui la rend très maniable autant pour le dentiste que pour le patient.

Équipement nécessaire pour une intégration correcte

Parallélomètre, accessoires/instruments, voir documentation Dental de Cendres+Métaux.

Remarque

Pour couler les parties mâles K constituées de Korak, il ne faut utiliser que des alliages ayant une limite élastique 0.2 % d'au moins 500 N/mm².

E = Elitor®

Au 68.60 %, Pt 2.45 %, Pd 3.95 %, Ag 11.85 %, Cu 10.60 %, Ir 0.05 %, Zn 2.50 %

D = Doral


Ag 49.3 %, Pd 20.0 %, Au 15.0 %, Cu 13.7 %, Ru 2.0 %

C = Ceramicor®

Au 60.0 %, Pt 19.0 %, Pd 20.0 %, Ir 1.0 %
T_s – T_L 1400–1490°C

O = OSV

Au 60.0 %, Pt 10.5 %, Ag 7.0 %, Pd 6.5 %, Cu 14.0 %, Zn 2.0 %
T_s – T_L 960–1065°C



Mode d'emploi**Important! Parallélisme en 3D**

Afin d'assurer les mouvements d'articulation des prothèses amovibles, les Mini-Dalbo® doivent être disposées parallèlement dans les trois dimensions (verticale, sagittale et horizontale).

Au **maxillaire supérieur**, la Mini-Dalbo® sera placée parallèlement au **plan médian** (Fig. 1).

A la **mandibule**, la Mini-Dalbo® sera placée selon la **bissectrice de l'angle** formé par la crête **C** et le plan médian **A** (Fig. 2).

Intégration des parties mâles C et K

Déterminer l'axe de montage en conformité avec le parallélisme en 3D et placer les parties mâles C ou K sur la maquette modelée de l'armature à l'aide de la tige de parallélomètre (070 146) et les fixer avec de la cire.

Partie mâle C: Coulée de raccord avec alliages précieux.

Partie mâle K: Couler en alliage précieux ou non précieux.

Contrôler la fonction de l'articulation après la coulée et cela avec les boîtiers en place (Fig. 3).

Intégration des parties mâles O

Pour la fixation par brasage au four de parties mâles en OSV sur des couronnes céramométalliques servant de support, il est conseillé, en raison de l'oxydation importante de l'OSV lors des traitements thermiques, de réaliser un brasage primaire (à main libre) de la partie mâle OSV sur la plaque de butée puis de faire un brasage après la cuisson. Placer ensuite la partie mâle à

l'aide de la tige de parallélomètre (070 146) en rapport avec l'axe d'insertion, fixer avec de la cire et réaliser un bloc pour brasage. Pour réaliser le brasage au four de la partie mâle/couronne, la même brasure et le même décapant que ceux utilisés pour le brasage primaire peuvent être utilisés.

Intégration des boîtiers E et D dans la prothèse amovible

Les deux versions de boîtiers ne doivent en aucun cas être fixés par brasage afin de préserver leurs caractéristiques mécaniques. Placer les boîtiers sur les sphères des parties mâles en position de repos (Fig. 4). Toutes les zones de contre-dépouille, les fentes des lamelles d'activation ainsi que les parois externes de la région des fentes d'activation doivent être comblées avec de la cire. Ceci évite une intrusion de résine dans les boîtiers au cours de la polymérisation et permet ainsi de conserver le jeu des lamelles et les possibilités d'activation et de désactivation de ces lamelles. La rétention aménagée à l'extrémité du boîtier garantit une fixation impeccable dans la selle prothétique.

Activation

La friction peut être réglée en pliant prudemment les lamelles vers l'intérieur avec un instrument plat.

Modifications / rebasages

En cas de modification ou de rebasage des prothèses, les axes de transfert (070 176) doivent être utilisés pour réaménager la situation des parties mâles sur le modèle de travail.

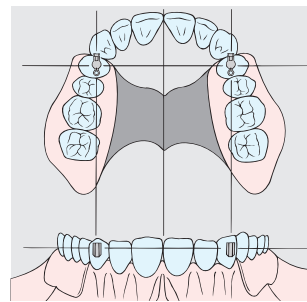


Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4

Suivi

Les éléments d'ancrage prothétique sont soumis en bouche à de fortes contraintes exercées dans un milieu en constante modification et sont ainsi plus ou moins sujets à des phénomènes d'usure. L'usure survient inmanquablement au fil de l'usage quotidien et ne peut ainsi pas être évitée mais seulement diminuée. Le degré d'usure est en rapport avec le système global même. Nous nous efforçons à mettre en oeuvre des matériaux harmonisés au mieux afin de pouvoir maintenir l'usure à un niveau le plus réduit possible. La bonne tenue d'une prothèse dentaire sur la muqueuse est à vérifier au moins une fois par an. Il est alors éventuellement nécessaire de faire un rebasage pour supprimer les effets de basculement (surcharges) et cela particulièrement pour les prothèses à extension distale. Nous conseillons, par mesure de sécurité, de remplacer la gaine de friction à l'occasion du contrôle annuel.

Les informations et recommandations concernant l'insertion, la désinsertion, les soins des prothèses peuvent être consultées par les patients sur le site Internet www.cmsa.ch/dental/infos pour patients.

Nettoyage & soins

Le mieux est de nettoyer vos dents et la prothèse dentaire après chaque repas. Le nettoyage de la prothèse dentaire comprend également celui de l'élément de fixation. Vous obtiendrez un résultat très doux en nettoyant l'élément de fixation à l'eau courante avec une brosse à dents à poils souples. On obtient un nettoyage plus intense en utilisant à cet effet un petit appareil à ultrasons avec un produit de nettoyage adéquat. Les éléments de fixation très délicats ne doivent jamais être nettoyés avec de la pâte dentifrice. Cela pourrait les endommager. De même, la prudence est de rigueur avec des produits ou comprimés nettoyants inadéquats. Ils pourraient également endommager le précieux élément de fixation ou ses fonctions. Quant à la contre-partie des éléments de fixation placés sur les dents restantes ou aux implants en bouche, ils se nettoient exclusivement à l'eau et une brosse douce ou encore avec une brosse interdentaire. Ne pas utiliser de pâte dentifrice afin d'éviter tout endommagement.

Veiller au nettoyage régulier de la glissière afin d'éviter toute inflammation des tissus mous.

Pour tout renseignement et information complémentaire, consulter la représentation Cendres+Métaux la plus proche.

Déni de garantie

La parution de ce mode d'emploi rend caduques toutes les versions antérieures.












Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent de la non-observation du mode d'emploi suivant.

Ces attachements sont des éléments d'un concept général et ne doivent être utilisés ou combinés qu'avec les composants et les instruments originaux correspondants.

Sinon toute responsabilité du fabricant sera déclinée.

Lors de réclamations, le numéro de lot doit toujours être indiqué.

Marquages sur l'emballage / Symboles

	Fabricant
	Numéro de catalogue
	Numéro de lot
	Quantité
	Consulter le manuel d'utilisation
Rx only	Attention : Selon la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par des professionnels de la santé autorisés ou sur leur ordonnance.
	Les produits Cendres+Métaux avec le sigle CE sont conformes aux exigences européennes.
	
	Ne pas réutiliser
	Non-stérile
	Conservé à l'abri du soleil
	Attention, voir document accompagnant